
Montaj Talimatı

R82 Chilla engelli çocuk puseti

Oksijen Tüpü Tutucu

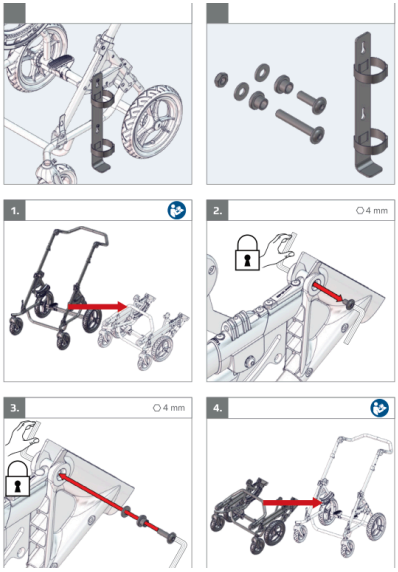



Oksijen tüpünü çerçevede güvenle taşımak için tutucunun montajı.

Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "5 mm" gibi ölçüler kullanılacak alyan (Allen) anahtarının boyutunu, "Nm" sıkma torkunu gösterir.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini gösterir.
- Montajdan sonra tüm vidaların sıkı olduğunu kontrol edin; çocuğu pusete ayarlar tamamlandıktan sonra oturtun.

Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50

Orijinal doküman: R82 / Etac, montaj talimatı 9996098173
Türkçe kapak: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz

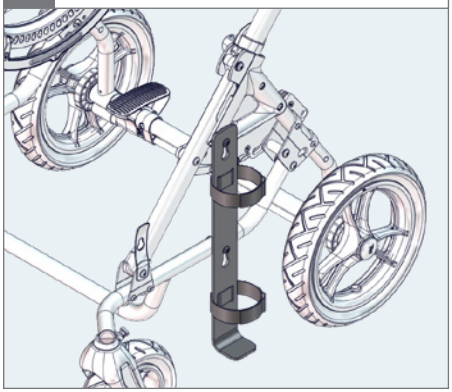


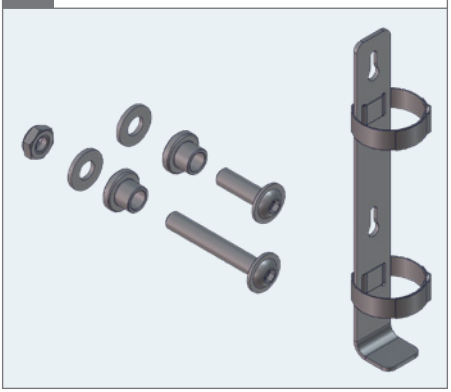


1.



2. ⬡ 4 mm

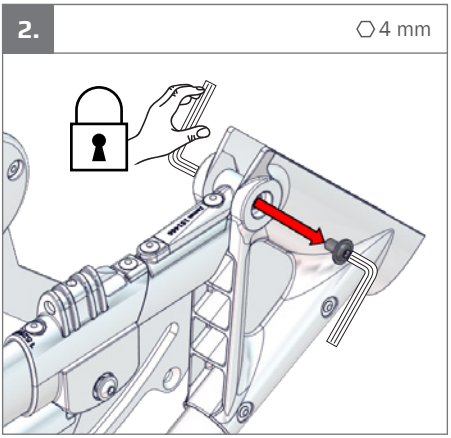


3. ⬡ 4 mm

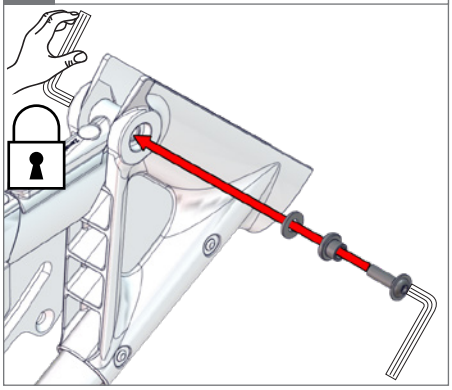


4.



5.

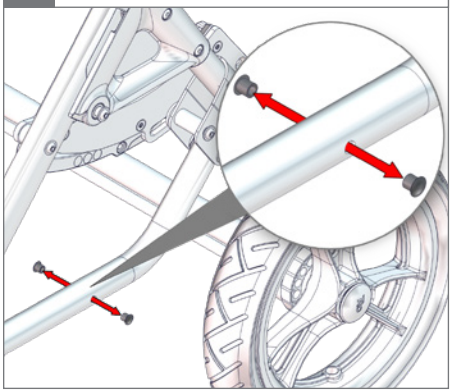

6. 10 mm ve 4 mm

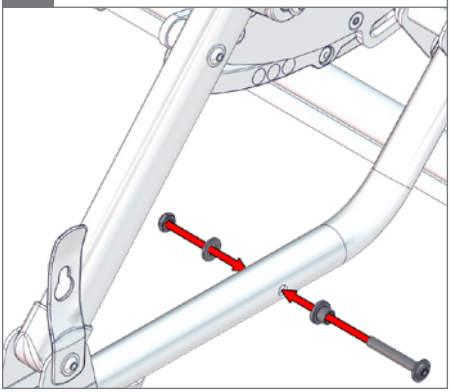

7.

